

■01-008 ルーツェ氏c128Hz 調節子(バランスウエイト)付

聴力検査に使用される。調節子を可動させることで128Hz～240Hzの7段階で周波数を変えることが可能。ハンドル底部の座は骨導の検査時に頭頂や乳様突起に当てやすく、振動を伝えやすい形状になっている。



【仕様】

全長:175mm 重さ:80g

材質:鋼(本体)/ 黄銅(ウエイト) / 樹脂(座)

JAN(GTIN-13)4582102815141

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDNコード 32526000

■01-009 ルーツェ氏 fis4 2896Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:140mm 重さ:125g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102815158

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-001 ハルトマン氏c128Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:160mm 重さ:77g

材質:鋼(本体)/ 黄銅(ウエイト)

JAN(GTIN-13)4582102816117

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-002 ハルトマン氏c¹256Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:135mm 重さ:64g

材質:鋼(本体)/ 黄銅(ウエイト)

JAN(GTIN-13)4582102816124

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-003 ハルトマン氏c²512Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:150mm 重さ:100g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102816131

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-004 ハルトマン氏c³1024Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:120mm 重さ:87g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102816148

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-005 ハルトマン氏c⁴2048Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:130mm 重さ:135g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102816155

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-007 ハルトマン氏 5 本組 木箱入り

聴力検査に使用される。



- 01-001 ハルトマン氏 c 128Hz
- 01-002 ハルトマン氏 c¹256Hz
- 01-003 ハルトマン氏 c²512Hz
- 01-004 ハルトマン氏 c³1024Hz
- 01-005 ハルトマン氏 c⁴2048Hz

■01-006 ハルトマン氏 c⁵4096Hz 音叉

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:130mm 重さ:130g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102816162

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-010 A 九大型 108.75Hz

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:340mm 重さ:125g

材質:アルミ

JAN(GTIN-13)4582102816193

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-012 1000Hz 劳基法準拠

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:130mm 重さ:94g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102815189

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-013 4000Hz 劳基法準拠

聴力検査に使用される。



【仕様】

全長:130mm 重さ:142g

材質:鋼

JAN(GTIN-13)4582102815196

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000

■01-021 C64Hz 振動覚音叉

糖尿病等による振動感覚機能検査に使用される。ウェイト部分の目盛りで客観的に判定することが出来る。座はくるぶし等に振動を伝えやすい形状になっている。



【仕様】

全長:230mm 重さ:148g

材質:炭素鋼(本体)黄銅(ウェイト)アルミ(座)

JAN(GTIN-13)4582102816186

医療機器届出番号 12B1X10005230001


一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDNコード 32526000

■04-048 脳外科用c128Hz

振動感覚機能検査や、聴力検査に使用される。

座は振動覚や骨導を検査する際に、振動を伝えやすい形状になっている。

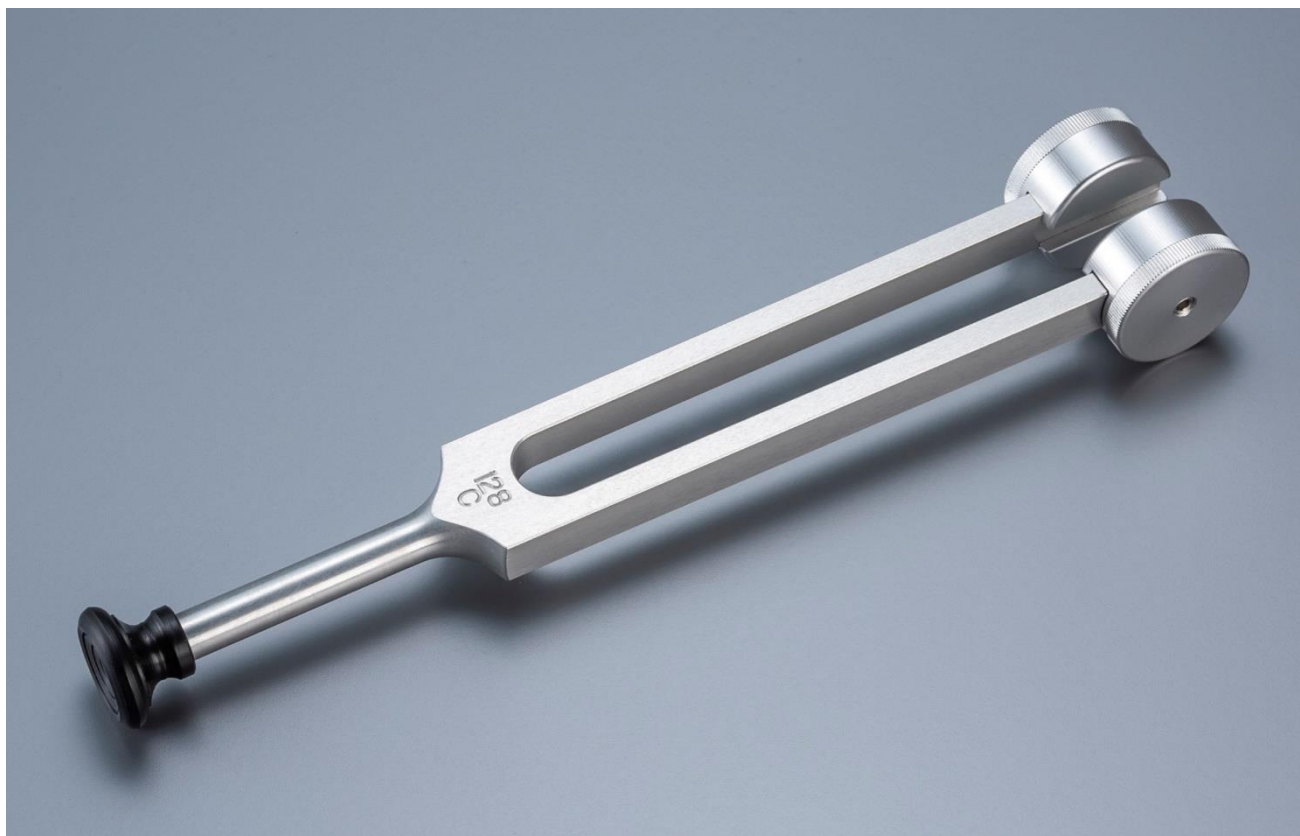

【仕様】

全長:210mm 重さ:98g 巾:40mm

材質:アルミ(本体・ウエイト)樹脂(座)

JAN(GTIN-13)4582102815165

医療機器届出番号 12B1X10005230001

一般医療機器(クラスⅠ)音叉

JMDN コード 32526000